

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目におきまして、検査方法および基準値を
変更させていただきご案内を致します。
何卒ご理解ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

●実施日 令和3年4月1日（木）ご依頼分より

●変更項目内容

検査項目名 (表示名称)	新		旧	
	検査方法	基準値	検査方法	基準値
アルブミン (ALB)	BCP改良法	※ 4.1～5.1 g/dL	BCG法	3.6～5.3 g/dL
LD (LD_IF)	IFCC法	※ 124～222 U/L	JSCC法	119～229 U/L
ALP (ALP_IF)	IFCC法	※ 38～113 U/L	JSCC法	115～359 U/L

※基準値出典：JCCLS共用基準範囲より

※IFCC法（IFCC：国際臨床化学連合）、JSCC法（JSCC：日本臨床化学会）

※ALP（ALP_IF）におきましては、旧法データの約1／3となります


※各項目における旧法と新法の比較データは裏面をご参照ください

お問い合わせ
株式会社CIS熊本中央研究所
TEL(096)284-1381

《 各検査項目相関データ一覧 》


アルブミン (ALB)

相関係数 $r = 0.9846$
 回帰直線 $Y = 1.112X - 0.480$
 $x\text{Mean} = 4.18$
 $y\text{Mean} = 4.17$

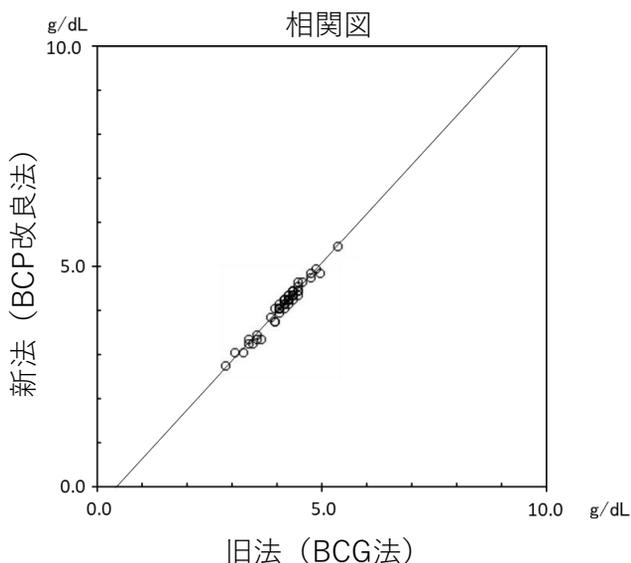

LD (LD_IF)

相関係数 $r = 0.9953$
 回帰直線 $Y = 0.997X - 7.961$
 $x\text{Mean} = 206.2$
 $y\text{Mean} = 197.7$

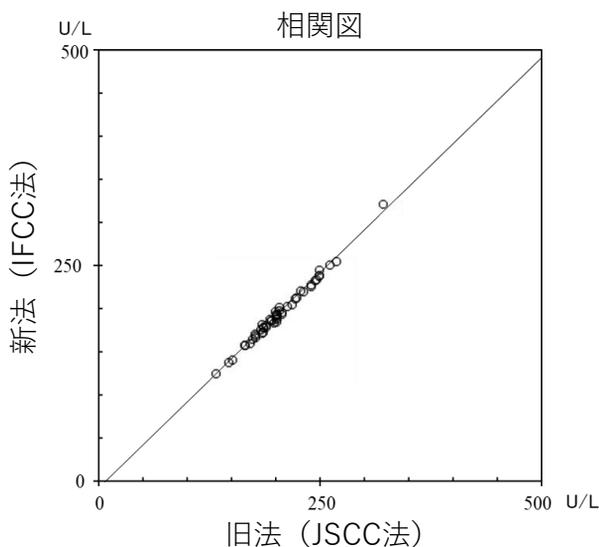

ALP (ALP_IF)

相関係数 $r = 0.9858$
 回帰直線 $Y = 0.317X + 4.328$
 $x\text{Mean} = 238.6$
 $y\text{Mean} = 80.0$

